Schutzvermerk nach DIN 34 beachten.
Use of the document / contents is forbidden
without express author. ity. All rights reserved.
DRAGERWERK AG, Luebeck

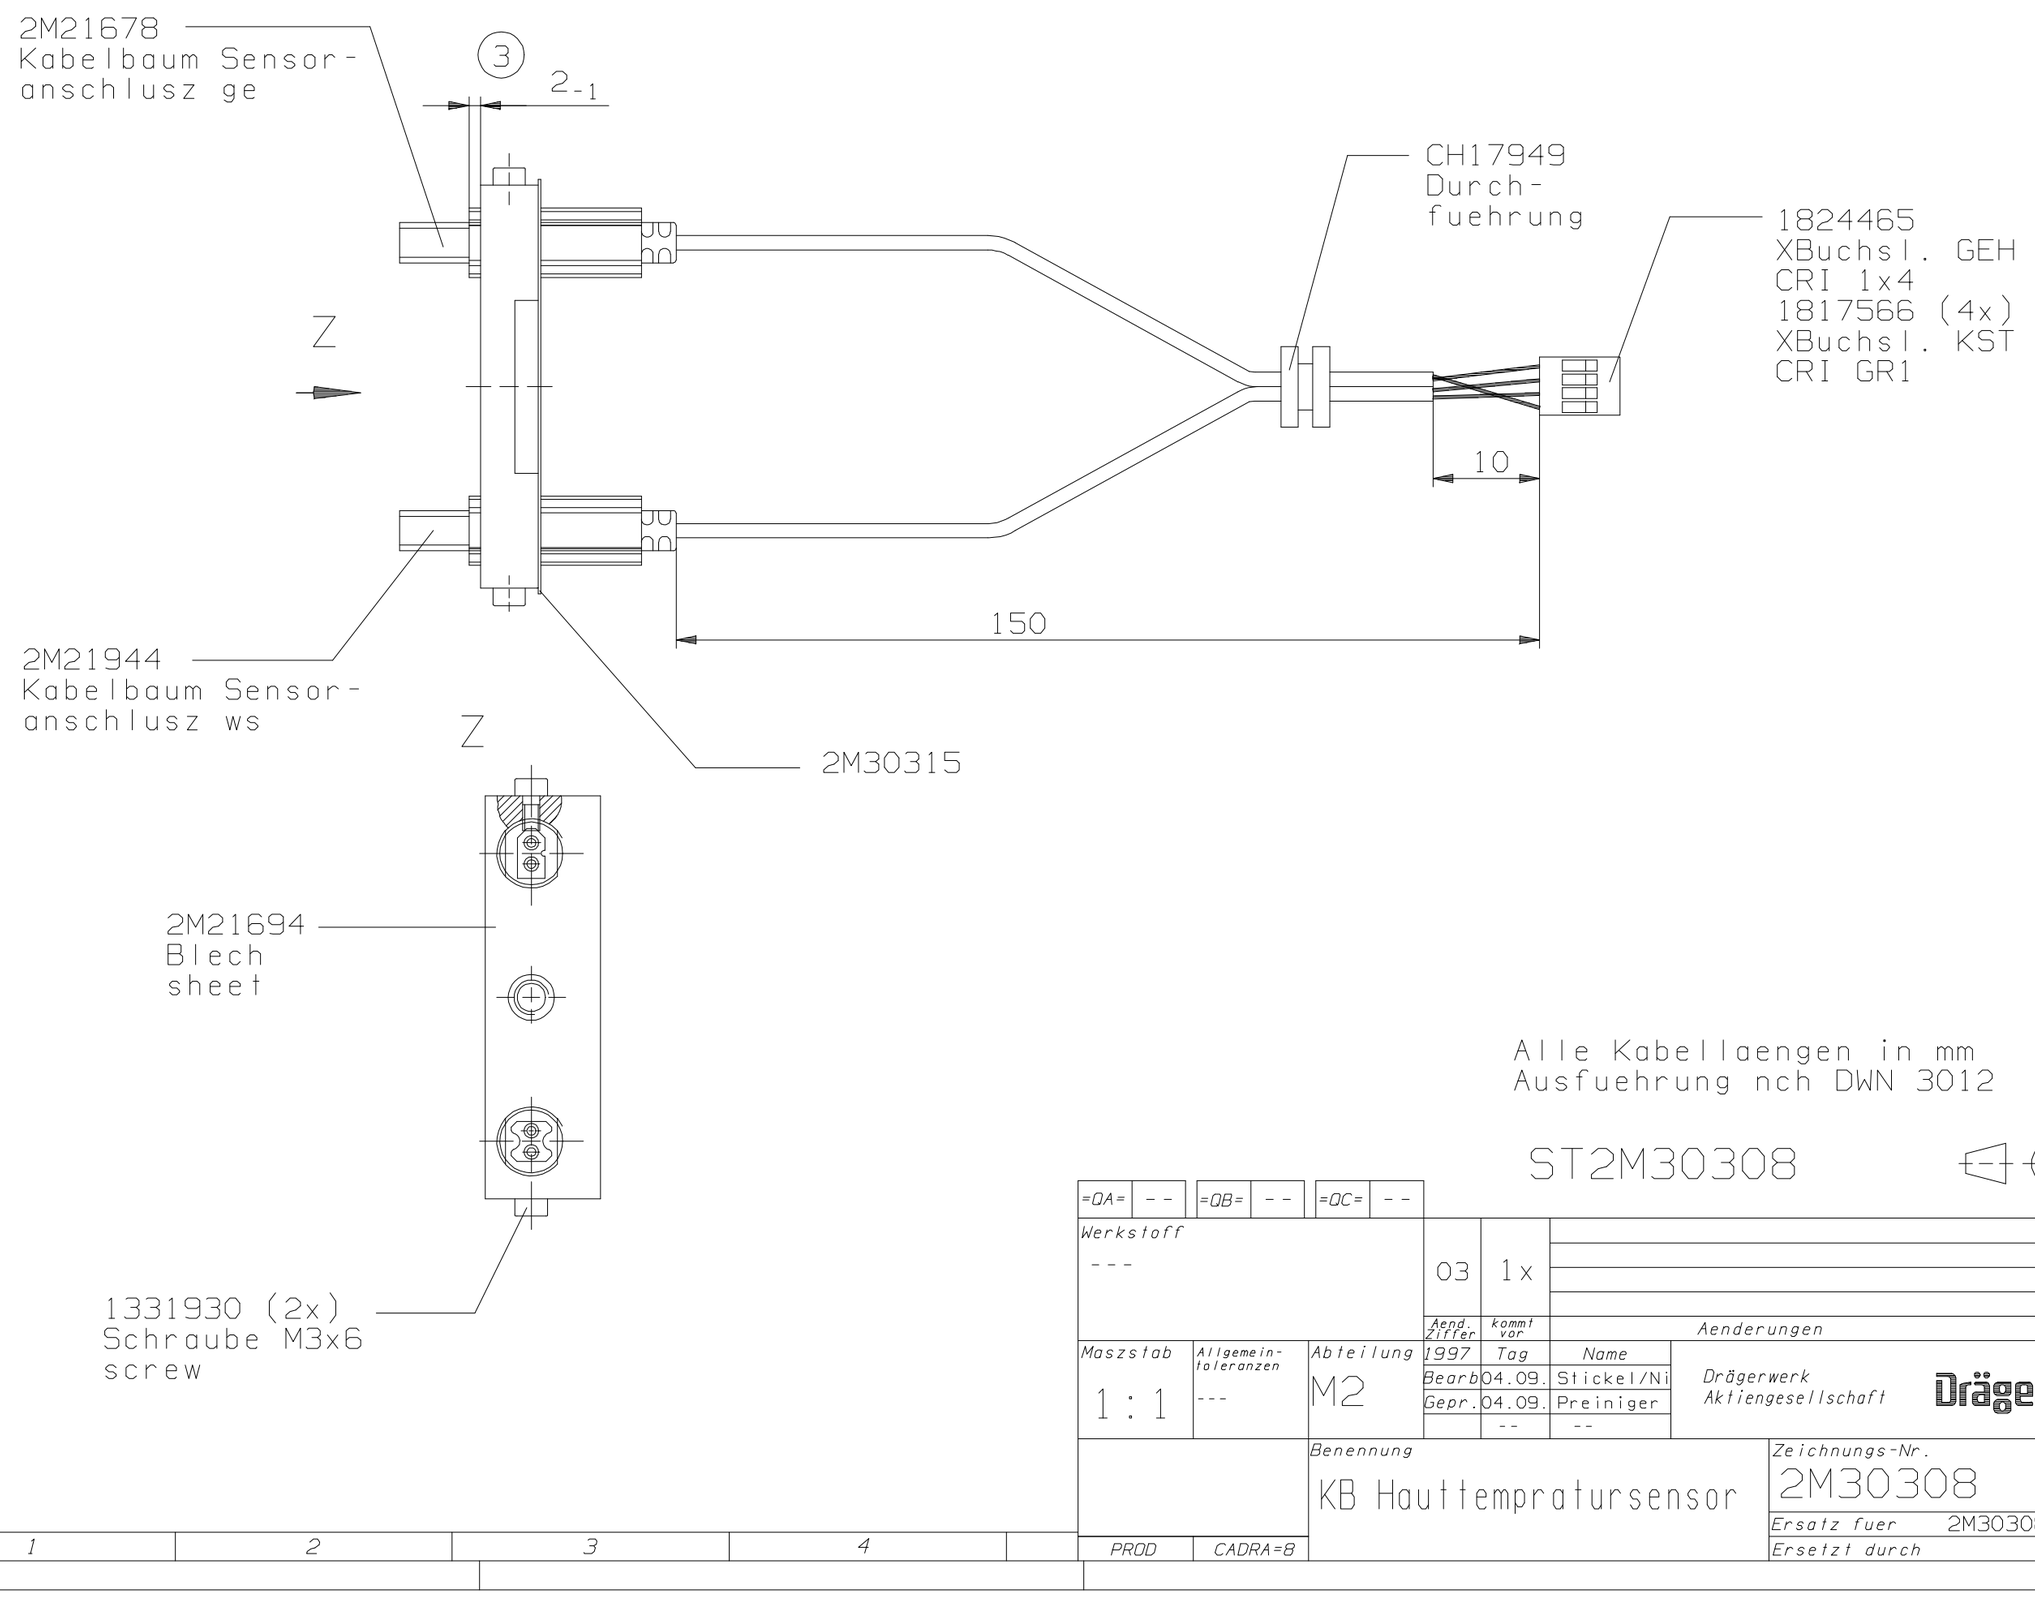

Alle Kabellaengen in mm
Ausfuehrung nch DWN 3012

ST2M30308

=QA= --	=QB= --	=QC= --					
Werkstoff ---			03	1x			
			Aend. Ziffer	kommt vor	Aenderungen		
Maszstab 1 : 1	Allgemein-toleranzen ---	Abteilung M2	1997	Tag	Name	Drägerwerk Aktiengesellschaft Dräger	
			Bearb	04.09.	Stickel/Ni		
			Gepr.	04.09.	Preiniger		
				--	--		
PROD	CADRA=8	Benennung KB Hauttempratursensor				Zeichnungs-Nr. 2M30308	
						Ersatz fuer 2M30308 02	
						Ersetzt durch	

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden.
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

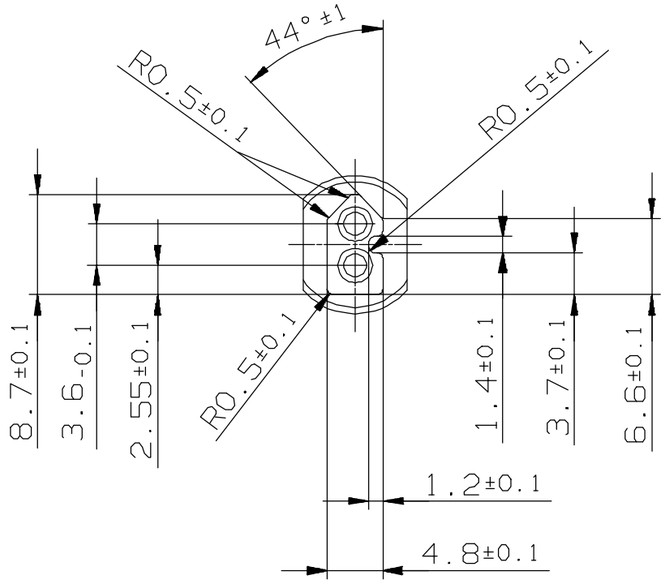

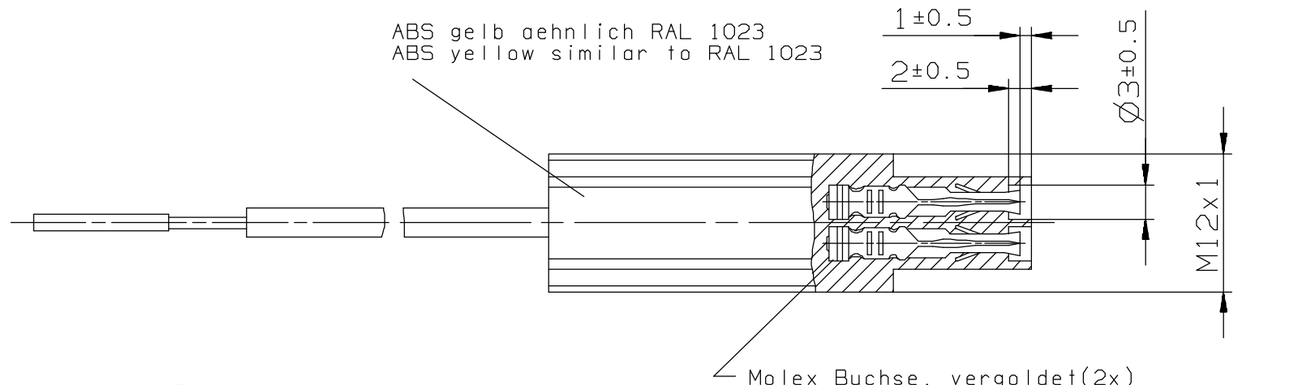

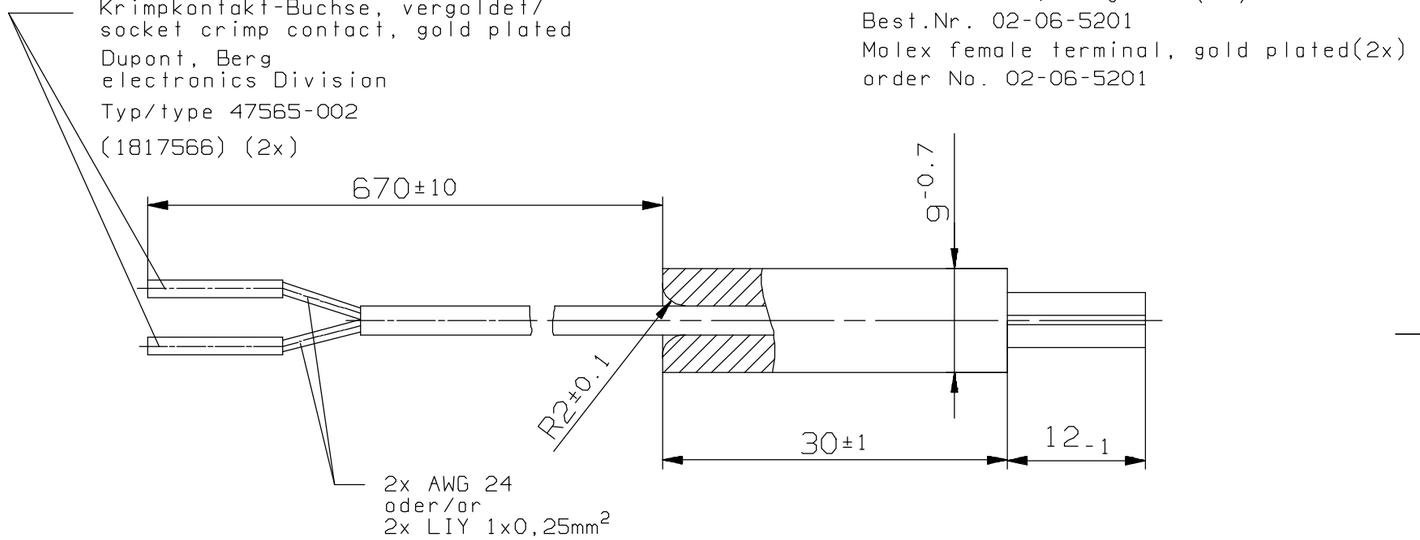

alle Abmessungen in mm

Farbe: gelb

Spannungsfestigkeit zwischen den Steckkontakten: 500V

all dimensions in mm

colour: yellow

voltage stability between contact pins: 500V

scale: 2:1	general tolerances	material		safety class: <s> 0, <m> 0
field reserved		revision text: neue Urzeichnung (99/MX/ 10)		
filing dept: 2950	responsible dept.: 5660		author / approved	contract: n
		date: 28.05.1999	28.05.1999	
		name: Bahrt	Conrad	
type: drawing	language: de	title: Kabelbaum Sensoranschlusz ge .		Dräger
	replacement for: 2M21678-04	number: 2M21678		
creating system: CADRA	release status: FREI	revision index: 05	occures: ox	page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH.
D-23542 Lübeck

size A3

Schutz nach DIN 34 beansprucht.
Use of the document / contents is forbidden
without express authority. All rights reserved.
Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

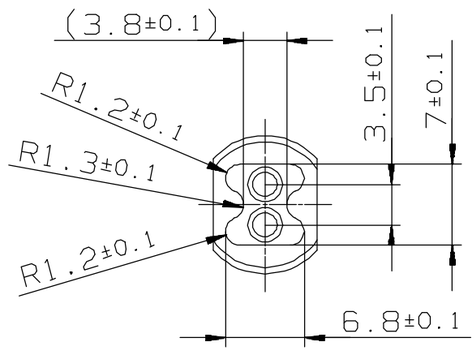

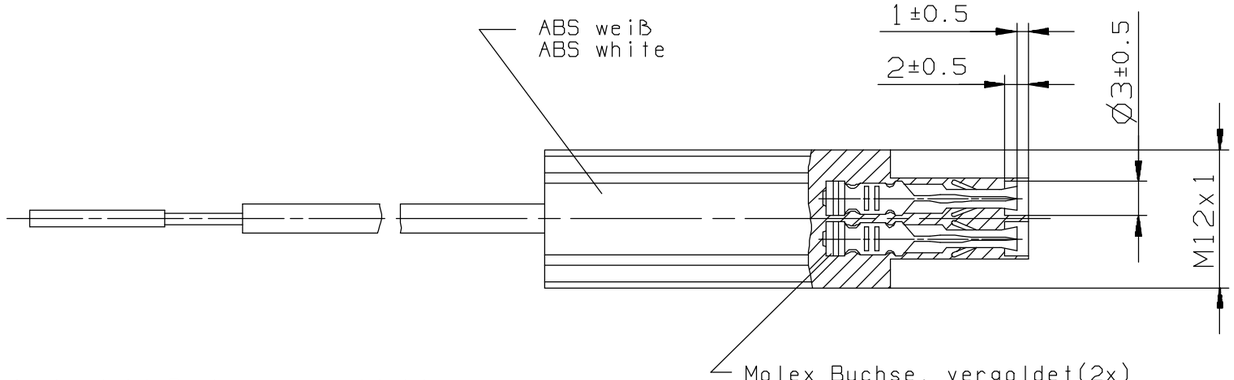

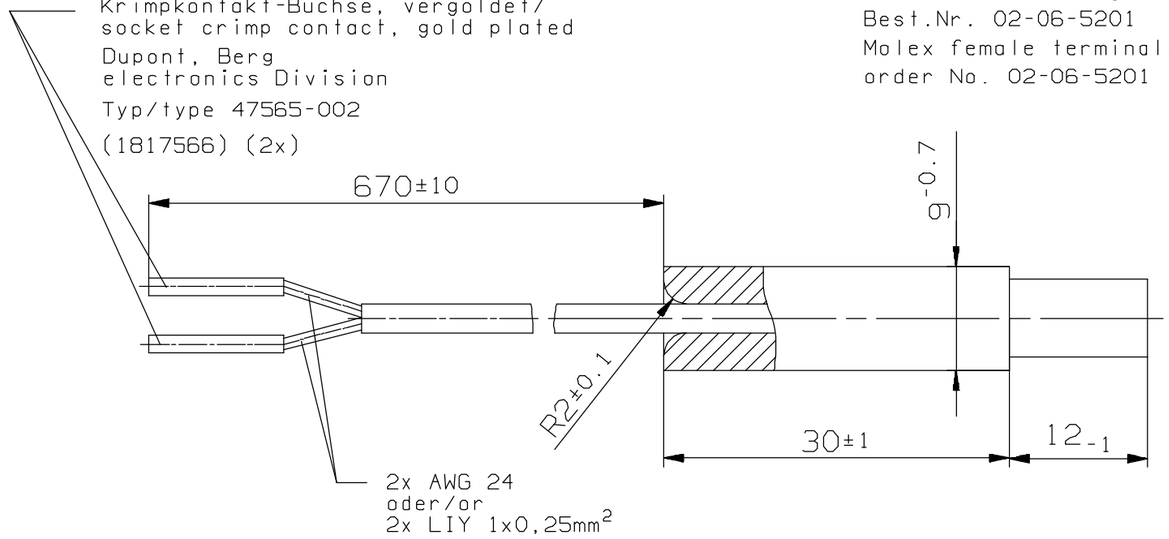

alle Abmessungen in mm

all dimensions in mm

Farbe: weiß

colour: white

Spannungsfestigkeit zwischen den Steckkontakten: 500V

voltage stability between contact pins: 500V

scale: 2:1	general tolerances:	material:	safety class: <s> 0, <m> 0
field reserved:		revision text: neue Urzeichnung (1999/MX/10)	
filing dept: 2950	responsible dept.: 5660	author: date 31.05.1999, name Bahrt	approved: 31.05.1999 Conrad; contract: n
type: drawing	language: de	title: Kabelbaum Sensoranschlusz ws	
	replacement for: 2M21944-03	number: 2M21944	
creating system: CADRA	release status: FREI	revision index: 04	occures: ox; page/of: 01/01

Dräger Medizintechnik GmbH, D-23542 Lübeck

size A3